BIP - Mam-O-Guide® prsní lokalizační vodič se zaváděcí kanylou pro nehmatné mamární léze

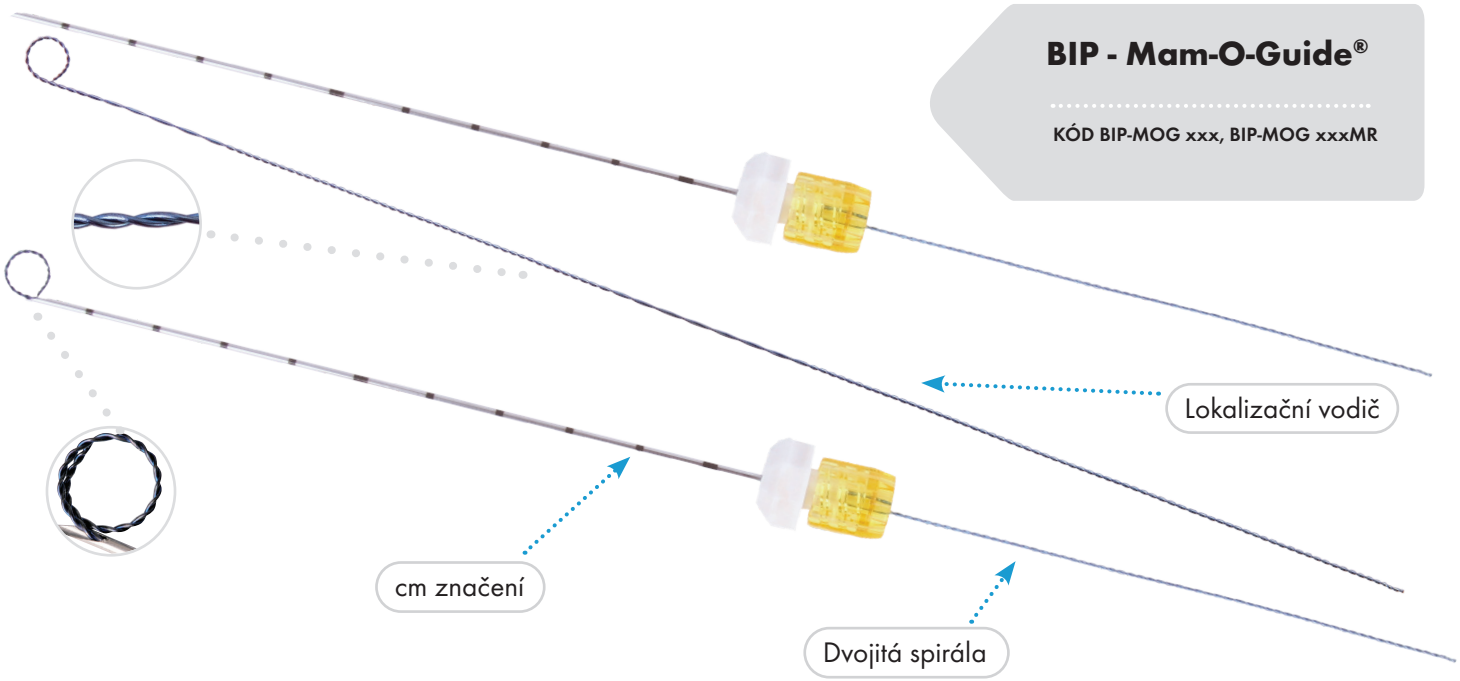

BIP - Mam-O-Guide® sestává z aplikační kanyly a lokalizačního vodiče, slouží k předoperačnímu vyznačení maligních oblastí v ženském prsu. Zavedení pod ultrazvukem, stereotakticky (mamografie) nebo pomocí diagnostiky MR .

Kruhová kotva

Při vysunutí lokalizačního vodiče z kanyly vznikne kruhový kotvící prvek, který zajišťuje optimální fixaci ve tkáni.

Poziční stabilita ve tkáni

Kruhová kotva zamezuje také tomu, aby lokalizační vodič nedopatřením nevstoupil do tkáně příliš hluboko, proto není třeba použít fixační prvek proti nežádoucímu posunutí.

Dvojitý vodič ve tvaru spirály

Lokalizační vodič má tvar dvojité spirály (včetně kruhového prvku). Tím je dána optimální viditelnost celého drátu pod ultrazvukem. Dvojité pletení vodiče jej chrání před neúmyslným přerušením. Hmatatelné značky před kruhovou kotvou umožní operatérovi, aby včas rozšířil vedení řezu.

Minimální nebezpečí poranění

Při aplikaci lokalizačního vodiče (vysunutí z kanyly) vytváří kruhový kotvící prvek, přičemž se hrot vodiče dotýká kruhové kotvy.Tudíž nejsou ve tkáni žádné ostré hroty, které by mohly vést k nechtěnému poranění operatéra.

Přesné umístění ve tkáni

Rovinu směřování kruhového prvku lze přesně stanovit ještě před vysunutím lokalizačního vodiče otáčením aplikační kanyly dle značky na plastové části aplikační kanyly.

Úprava polohy

V případě nesprávné polohy je možné označovací vodič vtáhnout zpět do kanyly a upravit polohu BIP - Mam-O-Guide®.

BIP - Mam-O-Guide® prsní lokalizační vodič se zaváděcí kanylou pro nehmatné mamární léze

Charakteristika a výhody BIP-Mam-O-Guide®

- Optimální ukotvení ve tkáni
- Možnost relokace (V případě nesprávné polohy lze lokalizační vodič stáhnout zpět do kanyly a **BIP - Mam-O-Guide®** lze nově zavést do správné pozice)
- Ultrazvukové zavádění pomocí vícenásobných odrazů na dvojité spirále
- K dostání provedení kompatibilní s MR
- Optimální hrot kanyly usnadní proniknutí do tkáně
- Není třeba použít fixační prvek proti nežádoucímu posunutí.

BIP - Mam-O-Guide®

KÓD BIP-MOG xxx, BIP-MOG xxxMR

Prstencovitý kotvící prvek ve tvaru dvojité spirály

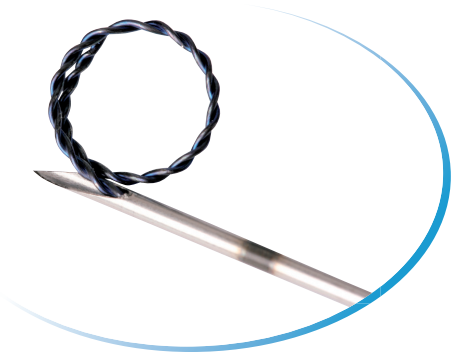

BIP - Mam-O-Guide®

Tabulka pro objednání výrobku, balení neobsahuje fixační prvek

KÓD	Průměr kanyly (G) / (mm)	Délka kanyly L (mm)	Kompatibilní s MR	Baleno v kartonu (ks)
MOG057	20 / 0,95	57	-	10
MOG077	20 / 0,95	77	-	10
MOG107	20 / 0,95	107	-	10
MOG137	20 / 0,95	137	-	10
MOG057MR	18 / 1,25	57	ano	10
MOG077MR	18 / 1,25	77	ano	10
MOG107MR	18 / 1,25	107	ano	10
MOG137MR	18 / 1,25	137	ano	10

VZP ČR KÓD:
0082498 BIP - Mam-O-Guide® standardní typ MOG xxx

SR KÓD:
Kód ŠÚKL P90714, Kód MZ SR X03547 BIP-Mam-O-Guide® standardní typ

tel.: +420 **530 502 705**
fax: +420 530 502 709
email: info@**bipmedical**.cz

BIP MEDICAL CZ, s.r.o.
Bohunická cesta 843/17
664 48 Moravany